

ブラウン管表示式アナライザ WE-2800

■機器概要

回答器 (WE-2521) からのデータを集計分析し、その結果をカラーブラウン管に表示する方式のグループアナライザで、データはプリンタで記録できます。また白黒のビデオ信号出力があり、VTR への録画も可能です。

1問1問ごとの反応を把握する基本分析機能 (個別反応、回答分布、時間累積、時間分布表示) の他に、30問までの集計データを分析する機能も付加されています。

重み付得点集計、平均値・標準偏差の計算、SP 表の作成、注意係数の計算、問題間の相関係数、得点分布・学生分布のグラフ表示などの多様な分析・表示機能を標準装備しています。

■機器構成

操作卓 (WE-2801)	1	回答器 (WE-2521)	最大64
アナライザ制御ユニット (WE-2810 u)	(1)	回答分布表示器 (WE-2880) オプション	1
操作パネル (WE-2830 u)	(1)	テープレコーダ (WE-6460) オプション	1
プリンタ駆動ユニット (WE-2891 u)	(1)	サイントーン (EC 540) オプション	1
RGB モニタ (WE-2840)	1		


■機器定格

電 源	AC 100V±10% 50/60Hz	性 能	パラメータ 設定機能	重み (各問への配点) を 1~9 に設定 到達率報知、締切 (報知、締切の選択、%値、 1%単位の設定、正答又は回答率の選択) 締切時間 (1秒単位) 設定 回答分布表示の、%選択
消費電力	約 200W (最大突入電流 15A)			
データ入力数	回答器 WE-2521 最大64台			
性 能	学 習 分 析 個別反応、回答分布表示 (グラフ、人% デジタル表示) 時間累積表示 (正答率、回答率グラフ、%デジタル値) 時間分布表示 (// //) 予約登録状況表示 (個別記録、正答表示集計、分析記録) 共通表示 (正答番号、重み問題番号、経過時間、 残り時間、到達率、到達後の動作予約)	その他の機能	正答フィードバック機能 (但し WE-2521 のとき) 回答分布表示 (正答点減表示) (但し、回答分布表示器接続のとき)	
		入 力	テープレコーダ録音入力 -20dB 10kΩ 以上..... 1	
		出 力	テープレコーダ書き込み信号 -20dB、2kΩ 1 白黒複合映像信号 1.0Vp-p/75Ω 1	
		使用温度範囲	0°C ~ +40°C	
能	データ分析 表示	寸 法	962(幅)×870(最大奥行)×990(高さ) mm	
		重 量	約 80 kg	
記 録	画面プリント (グラフはキャラクタに変換して印字) 分析記録 (得点表、SP表...注意係数同時) 個別記録 (個別反応、回答分布表示)	仕 上	操作パネル: マンセル5Y7.5/1 テーブルおよびテレコ収納部: デコラ貼り (スノーホワイト) 側板: マンセル2.5YR5/10 塩ビレザー貼り	

■付属品 (WE-2801)

テープレコーダリモコンケーブル.....	1	ペーパーシャフト.....	1
同軸コネクタ (M型 3C用 アダプタ付).....	1	プリンタロール紙.....	1
信号ケーブル (テープレコーダ録再用).....	2	ヒューズ (2A, 5A)	各 1
ショートコネクタ (角形15ピン).....	1	座席表.....	3
回答器接続基板.....	8	モニタ TV 用電源ケーブル.....	1
モニタ TV 後面カバー.....	1	モニタ TV 用信号ケーブル.....	1
後面カバー取付けアングル.....	2	モニタ TV 用終端プラグ.....	1
座席表示ホルダー.....	1	取扱説明書.....	1
取付けねじ (アングル用).....	4	工事説明書.....	1
取付けねじ (カバー用).....	2	保証書.....	1

■ 系統図

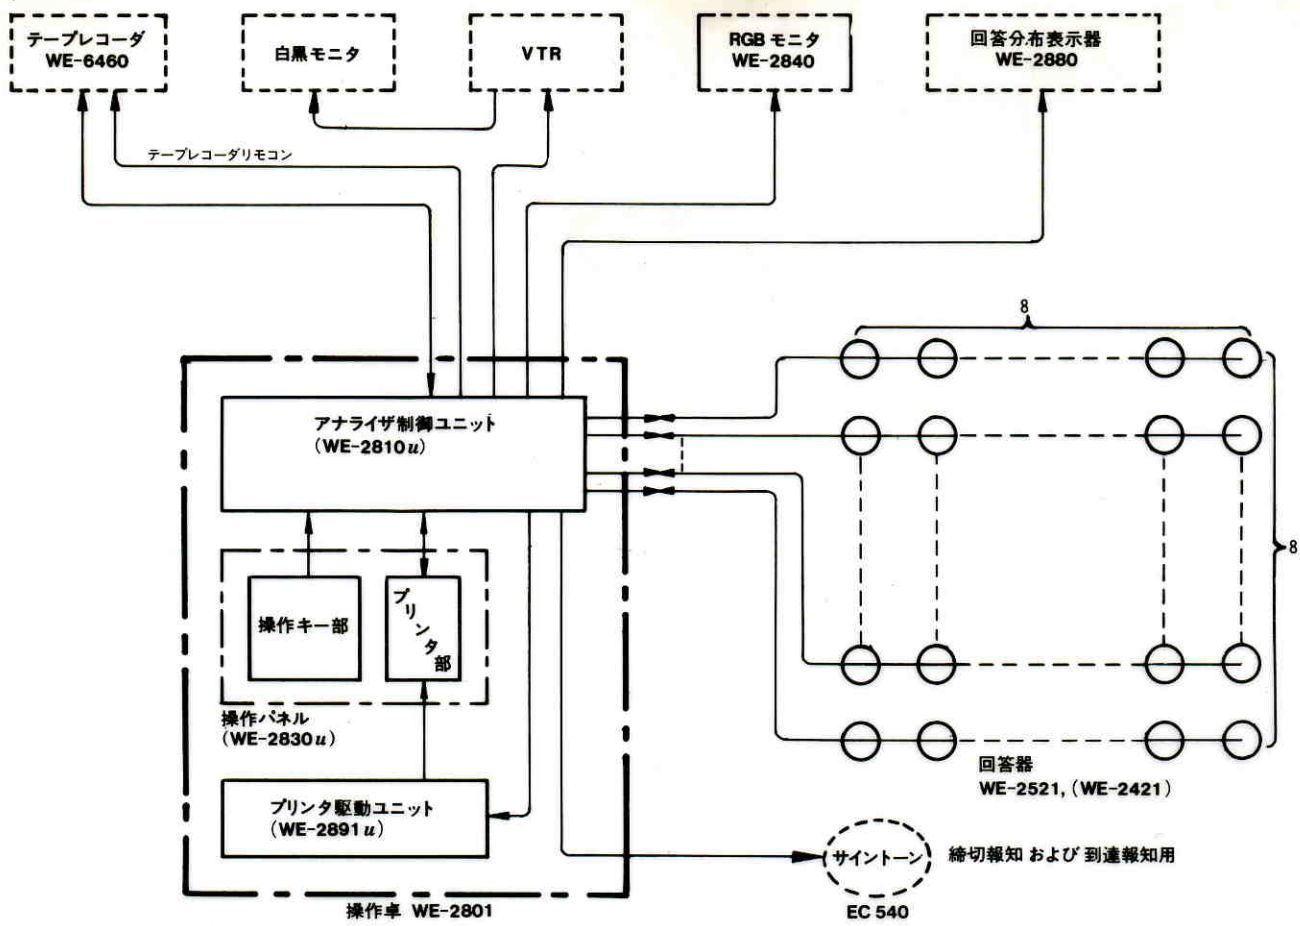

■ 外観寸法図

